

access

Une gamme de produits **économiques**
pour une pratique dentaire **plus rentable**


GO-TAPER

Conicité variable

Rotation continue 

La séquence
endodontique NiTi
jusqu'à **50% moins chère**


Testez



GO-TAPER

SATISFAIT ou REMBOURSÉ*

CAS STANDARDS

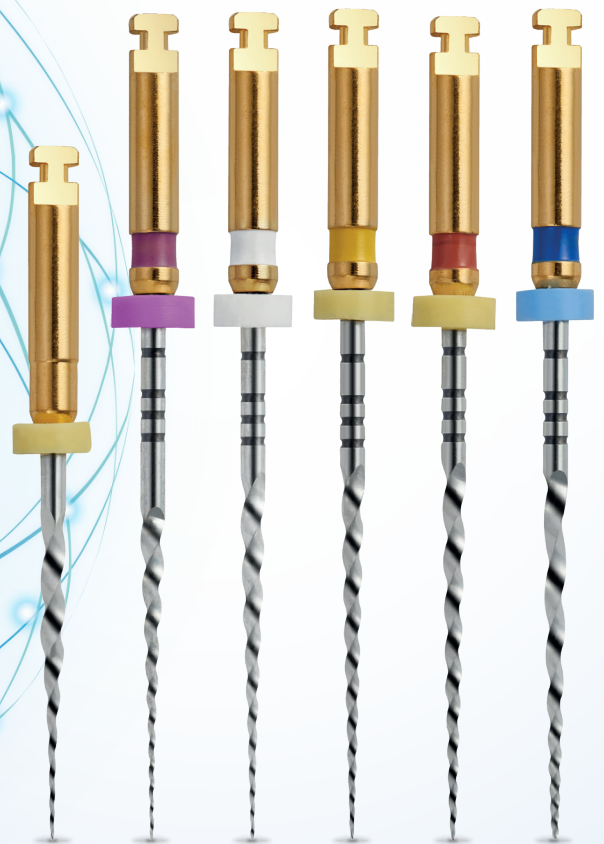

AVEC **GO-TAPER**


**RETROUVEZ
LES SENSATIONS
ORIGINALES !**




GO-TAPER UNIVERSAL

RETROUVEZ LES SENSATIONS
ORIGINALES !


POUR TRAITEMENT




Flexibilité



Pouvoir
de coupe



Résistance



Stérilisables
à 134°C

x 6




GO-TAPER UNIVERSAL	LONGUEUR			
	19 mm	21 mm	25 mm	31 mm
KIT ASSORTI	-	3107604	3107612	3107620
A0 - 4% - ISO 19	3107596	-	-	-
A1 - 2% - ISO 18	-	3107597	3107605	3107613
A2 - 4% - ISO 20	-	3107598	3107606	3107614
B1 - 7% - ISO 20	-	3107599	3107607	3107615
B2 - 8% - ISO 25	-	3107600	3107608	3107616
B3 - 9% - ISO 30	-	3107601	3107609	3107617
B4 - 6% - ISO 40	-	3107602	3107610	3107618
B5 - 5% - ISO 50	-	3107603	3107611	3107619

GO-TAPER RETREATMENT

POUR RETRAITEMENT

x 6

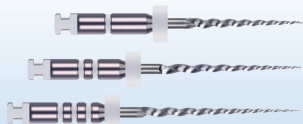

- Pour une **ÉLIMINATION** de l'obturation endodontique
- **INSTRUMENTS ADAPTÉS** à chaque tiers du conduit radiculaire

GO-TAPER RETREATMENT	LONGUEUR	RÉFÉRENCE
KIT ASSORTI	Assortie	3148446
C1 - 9% - ISO 30	16 mm	3148443
C2 - 8% - ISO 25	18 mm	3148444
C3 - 7% - ISO 20	22 mm	3148445

* La garantie « satisfait ou remboursé » s'applique exclusivement dans le respect des données suivantes : ■ La garantie n'est valable que dans un délai de cent jours à date de facturation.
■ La garantie s'applique à des produits non déballés et non utilisés, à l'exception d'une boîte de 6 limes pour test. ■ Les produits doivent être retournés à la société dans les emballages et suremballages d'origine et accompagnés du motif de la demande d'échange ou de remboursement et d'une photocopie d'un devis ou d'une facture d'achat après avoir obtenu un accord de retour sur le site dans le compte du client ou auprès du Service Clients. ■ Dans tous les autres cas, la garantie ne pourra être appliquée.
GO-TAPER : dispositifs médicaux de classe IIa. Fabricant légal : CFPM. DM classe IIa. Marquage CE 0425. Organisme notifié ICIM. **Photos non contractuelles.**